

**Протокол итогов №14  
осуществления закупа «медицинских изделий»  
способом запроса ценовых предложений**

г. Астана

«22» февраля 2024 года

ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №3» акимата города Астаны, 010000, г.Астана, район Есиль, ул.Т.Рыскулова 12, в лице организатора закупок в соответствии с главой 3 раздела 2 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила) провело закупки **медицинских изделий** на 2024 год, способом запроса ценовых предложений.

Комиссия, для проведения закупок в следующем составе:

**Председатель комиссии:**

Утегенова Р.Б. - заместитель директора по медицинской части;

**Заместитель председателя комиссии:**

Бейсембаева Г.М. - заведующая аптекой;

**Члены комиссии:**

Сагатова М.С. – заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению;

Кусаинова Д.К. – главная медицинская сестра;

Бейсеналы М.М.- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности;

**Секретарь комиссии:**

Кыстаубаева Ж.Б. – менеджер отдела правового обеспечения и государственных закупок.

На момент окончания приема ценовых предложений 10:00 часов 21 февраля 2024 года, были представлены ценовые предложения от следующих потенциальных поставщиков:

| № | Наименование потенциального поставщика | Дата и время предоставления ценового предложения |
|---|--|--|
| 1 | ТОО «Гелика»                           | 16.02.2024 14:00                                 |
| 2 | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ"       | 16.02.2024 14:15                                 |
| 3 | ТОО «Beatus via»                       | 20.02.2024 09:40                                 |
| 4 | ТОО «САПА Мед Астана»                  | 20.02.2024 11.25                                 |
| 5 | ТОО «Ангрофарм-НС»                     | 21.02.2024 08:45                                 |
| 6 | ТОО «Братья Азизляр ИКО»               | 21.02.2024 09:00                                 |

Сумма, выделенная для закупок, а также информация о представленных ценовых предложениях потенциальных поставщиков указаны в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

По итогам рассмотрения представленных ценовых предложений потенциальных поставщиков, комиссия согласно пункту 78 Правил, **РЕШИЛА:**

1. По лоту №5 признать победителем и заключить договор о закупе с **ТОО «Братья Азизляр ИКО»**, находящимся по адресу, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,127, на сумму **395 000 (Триста девяносто пять тысяч) тенге 00 тиын**, в сроки, установленные Правилами.
2. По лоту №6 признать победителем и заключить договор о закупе с **ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ"**, находящимся по адресу, г.Алматы, ул.Луганского, 54В, на сумму **819 000 (Восемьсот девятнадцать тысяч) тенге 00 тиын**, в сроки, установленные Правилами.
3. По лоту №7 признать победителем и заключить договор о закупе с **ТОО «Ангрофарм-НС»**, находящимся по адресу, г.Астана, пр.Тәуелсіздік, 12/1, на сумму **666 710 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот десять) тенге 00 тиын**, в сроки, установленные Правилами.
4. Признать закуп по лотам № 1,2,3,4 несостоявшимся. Не представлены ценовые предложения.
5. Отклонить ценовое предложение **ТОО «САПА Мед Астана»** по лоту №7 ввиду несоответствия представленного товара технической спецификации Заказчика (не соответствие размеров аспирационной иглы (в представленном РУ нет требуемых размеров); поршень не имеет двух уплотнителей; игла не имеет встроенный фильтр тонкой очистки 15мкм).


**Председатель комиссии:**

Утегенова Р.Б.



**Заместитель председателя комиссии:**

Бейсембаева Г.М.


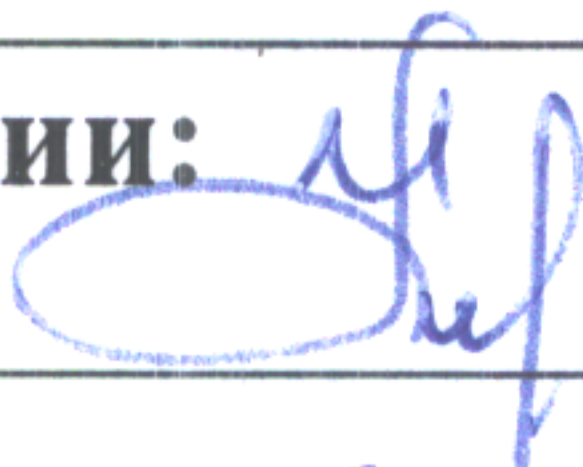


**Члены комиссии:**

Сагатова М.С.


Кусаинова Д.К.

Бейсеналы М.М.

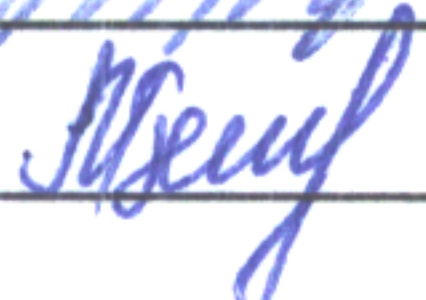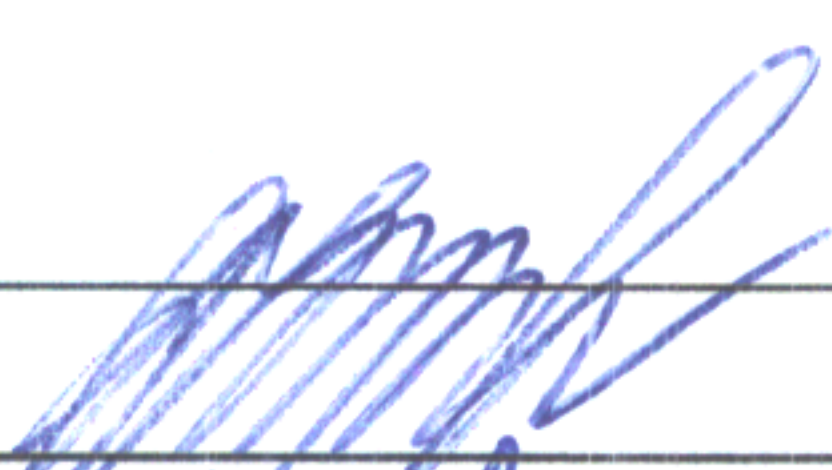

**Секретарь комиссии:**

Кыстаубаева Ж.Б.

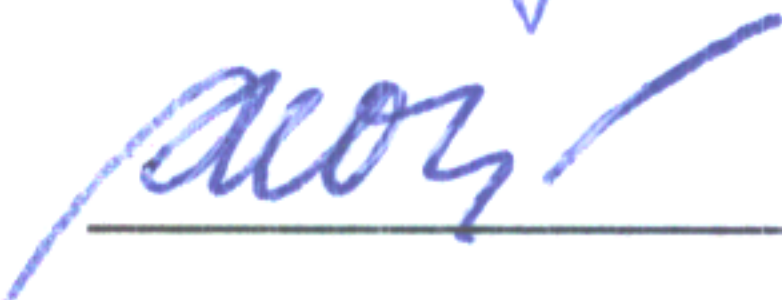

Перечень закупок медицинских изделий

| № лота | Наименование  | Техническая спецификация  | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупки, тенге | TOO "MEDICAL MARKET NG GROUP KZ" | TOO Ангрофарм-НС | TOO Братъя Азияр ИКО | TOO САПА Мед Астана via | TOO Beatus | TOO Гелика |
|--------|---|---|---------|------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1      | Подушка кислородная 25л   | Подушка кислородная изготовлена в виде мешка из плотной порезиненной ткани, объемом 25 литров. Подушка оборудована нисходящей трубкой с зажимом, которая подключается к мунштуку или маске. Устройство многооразовое и подлжит перезарядке кислородом. Комплект поставки: подушка кислородная 25л, трубка подачи кислорода, зажим с колесиком для прекращения подачи кислорода, пробка, кислородная маска. Технические характеристики кислородной подушки: размеры 73+/-0,5смх35+/-0,5см. Цвет подушек: верхняя сторона подушки синяя с нанесенным логотипом, нижняя - желтая. Максимальное рабочее давление 10кПа. Рабочее время хранения кислорода в подушке 7-10 дней при условии правильной эксплуатации.   | штука   | 9          | 7 000,00               | 63 000                               |                                  |                  |                      |                         |            |            |
| 2      | Бумага ЭКГ диаграмная   | Бумага ЭКГ диаграмная размер 210*25*16  | шт      | 50         | 800,00                 | 40 000                               |                                  |                  |                      |                         |            |            |
| 3      | Контейнер для анализов с лопаткой   | Контейнер изготовлен из пропилена с герметично закрывающейся крышкой Объем 150мл стерильный с ложкой  | шт      | 50         | 150,00                 | 7 500                                |                                  |                  |                      |                         |            |            |
| 4      | Бумага для видеопринтера UPR-110S   | размер 110мм на 20 м №10  | шт      | 28         | 7000                   | 196 000                              |                                  |                  |                      |                         |            |            |
| 5      | Электроды для ЭКГ одноразовые твердый гель 23*34мм (под зажим типа крокодил) №100 | Электроды для ЭКГ одноразовые твердый гель 23*34мм (под зажим типа крокодил) №100   | упак    | 50         | 8 000,00               | 400 000                              |                                  |                  | 7900                 |                         |            |            |
| 6      | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер педиатрический                        | Педиатрический набор трехпросветного катетера для катеризации верхней полой вены по методу Сельдингера.<br>Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0,8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несъемной разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термостабильный, антитромботический, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G16/F5 (1,7 x 13см), каналы G20/22/22, скорость потока 29/10/10 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирующие крыльшки. Нитиноловый проводник 0,46мм x 0,018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибостойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера. Универсальный адаптер для постановки центрального венозного катетера под контролем ЭКГ. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт      | 45         | 24 000,00              | 1 080 000                            |                                  |                  |                      |                         |            |            |
| 7      | Шприц к Перфузору 50 мл   | Шприц к Перфузору 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1,7 x 2,0 x 30мм. Соединение Луэр Лок. Не содержит Латекс и ПВХ. Легко разъезжаемая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл.<br>- Аспирационная игла 1,7 x 2,0 x 30мм.<br>- Встроенный фильтр тонкой очистки 1,5 мкм<br>- Минимальный остаточный объем, нестираемая четкая градуировка. - Герметичное и надежное винтовое соединение Луэр лок.<br>- Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии.<br>- Исключительные характеристики скольжения поршня.<br>- Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена.   | шт      | 1102       | 925,00                 | 1 019 350                            | 18200                            |                  |                      |                         | 18280      |            |